



獨立式微漏氣*iLAL*利用床管交替時所排出的空氣送回床墊內,藉以帶走氣墊床多餘的熱氣及溼氣,降低床墊溫度確保床墊乾爽舒適。

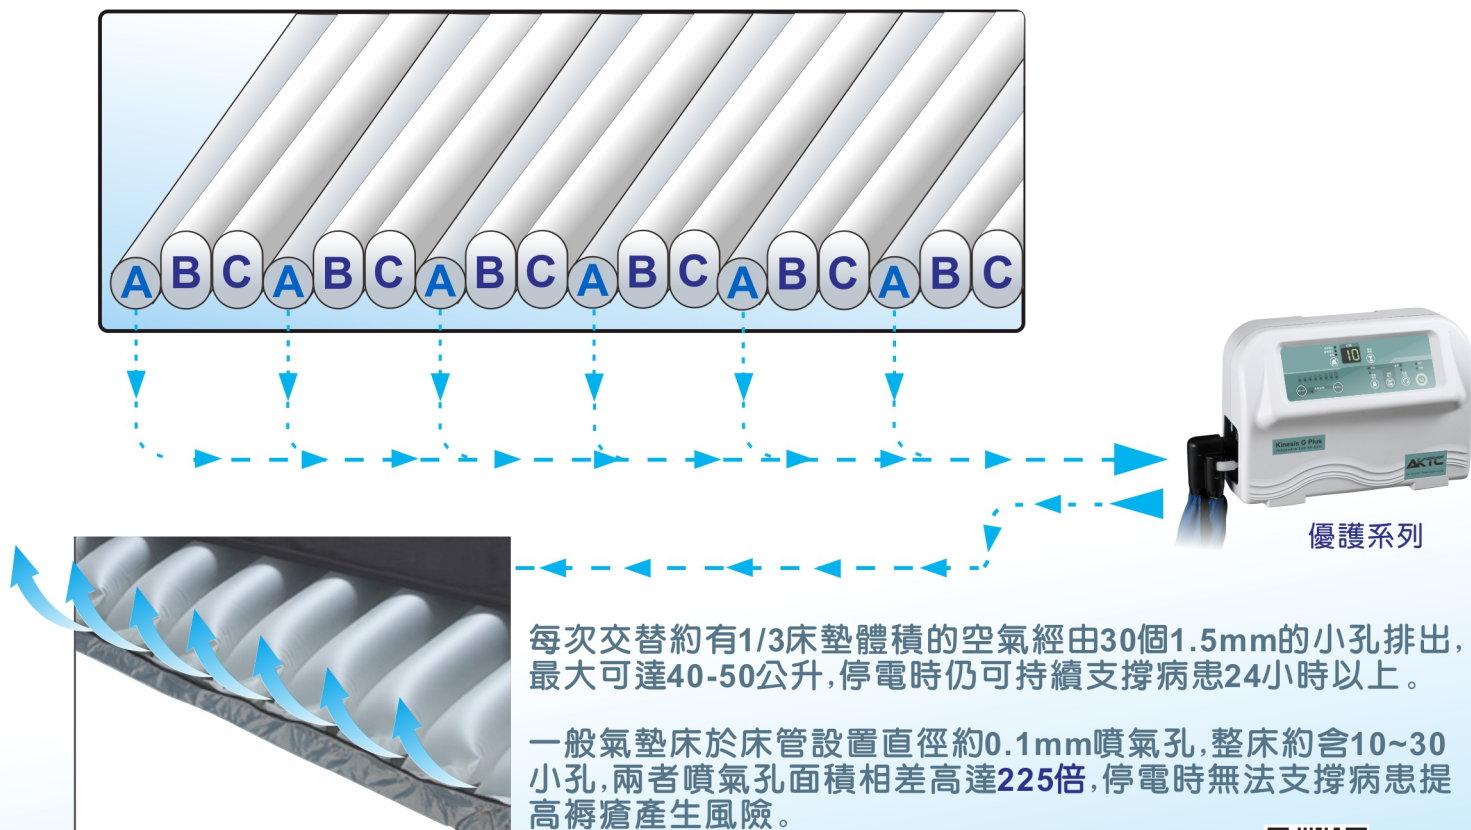

掃描QR Code觀看動畫

傳統式微漏氣設計為直接於床管上做破壞性開孔(俗稱Low Air Loss, Ventilation Air),此種做法常因開孔不良或孔洞擴大造成管條壓力不足。另,傳統式微漏氣氣墊床搭配一般流量空氣幫浦(流量約5-20公升/分鐘),因幫浦流量小,氣墊床無法同時進行微漏氣與病患支撐。若要達成上述功能,不是開孔過大造成管條漏氣,就是開孔太小完全沒有空氣排出。

真正有效的Low Air Loss(或稱True Low Air Loss)是必須搭配高流量的鼓風機(>1000公升/分鐘)如唐德Optimal Pro系列,才能達到Low Air Loss微漏氣效果。

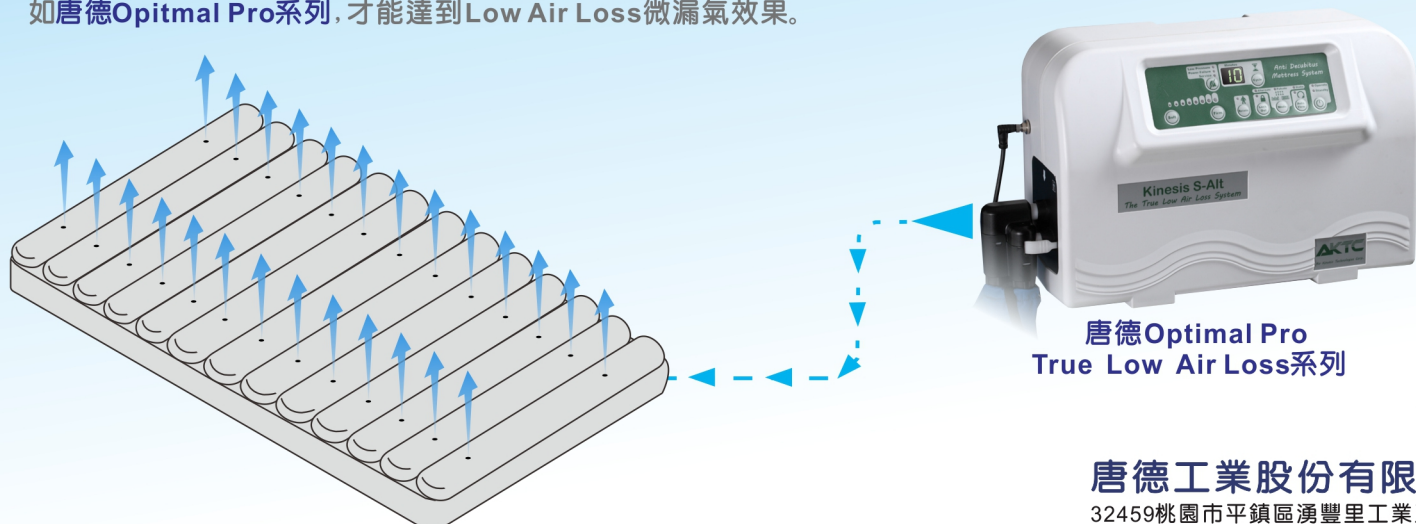

唐德工業股份有限公司

32459桃園市平鎮區湧豐里工業五路3號
消費者服務專線:0800-211-365
電話:(03)419-4567 傳真:(03)469-3789
電郵:service@aktc.com.tw
網址:www.aktc.com.tw